

TenuPol-5

研磨ユニット

取扱説明書

取扱説明書原本の翻訳



CE

文書番号: 14087025-01_B_ja
発行日: 2024.02.16

著作権

本取扱説明書の内容は、Struers ApSに帰属します。Struers ApSの書面による了承を得ずに、本取扱説明書の全部又は一部を複製することを禁じます。

無断複写・転載を禁じます。© Struers ApS.

目次

1	説明書について	5
1.1	アクセサリと消耗品	5
2	安全性	5
2.1	使用目的	5
2.2	TenuPol-5安全に関する注意事項	6
2.2.1	ご使用前に必ずお読みください	6
2.3	安全メッセージ	7
2.4	本説明書の安全メッセージ	8
2.5	電解液の使用	11
2.5.1	過塩素酸	12
3	はじめに	15
3.1	装置の説明	15
3.2	概要 - TenuPol-5	16
3.2.1	制御パネルの機能	17
4	輸送と保管	17
4.1	輸送	18
4.2	保管	18
5	設置	19
5.1	装置の開梱	19
5.2	パッキングリストの確認	19
5.3	設置場所	20
5.4	電源供給	21
5.4.1	電圧	21
5.5	研磨ユニットの接続	22
5.6	装置の操作準備	22
5.6.1	研磨ユニットのセットアップ	22
5.6.2	容器に電解液を充填する	23
5.6.3	ジェットホルダの取り付け	24
6	メンテナンスと保守	25
6.1	手動機能	25
6.1.1	電解液の交換	26
6.1.2	クリーニング	28
6.1.3	ポンプの手動操作	29
6.2	毎日	30

6.2.1 クリーニング	31
6.2.2 制御ユニット	32
6.3 毎月	32
6.3.1 ポンプをキャリブレーションする	32
6.4 毎年	34
6.4.1 安全装置のテスト	34
6.5 予備部品	35
6.6 廃棄	35
6.7 サービスおよび修理	35
7 トラブルシューティング	36
8 技術データ	36
8.1 技術データ - TenuPol-5	36
8.2 騒音レベルと振動レベル	37
8.3 安全回路カテゴリ/パフォーマンスレベル	37
8.4 制御システムの安全関連部品 (SRP/CS)	37
8.5 図	38
8.5.1 図 - TenuPol-5	38
8.6 法的小および規制情報	41
9 製造元	41
適合宣言書	43

1 説明書について

**注意**

Struersの装置は、必ず装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。

**注記**

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

**注記**

特定の情報の詳細を見るには、本説明書のオンライン版をご覧ください。

1.1 アクセサリーと消耗品

アクセサリ

利用可能な範囲に関する詳細は、TenuPol-5 のカタログをご覧ください:

- [Struersウェブサイト](http://www.struers.com) (http://www.struers.com)

消耗品

本装置は、この目的およびこの種の装置専用設計されている Struers の消耗品のみを使用するように設計されています。

その他の製品には、ゴムシールなどを溶かす強力な溶剤が含まれている場合があります。Struersの純正消耗品以外を使用したことに直接関係する損傷の場合は、損傷した部品（シール、チューブなど）は保証の対象外となることがあります。

利用可能な範囲に関する詳細は、こちらを参照してください: [Struersウェブサイト](http://www.struers.com) (http://www.struers.com)

2 安全性

2.1 使用目的

ユニットは、次の組み合わせで使用します。

- TenuPol-5 制御ユニット

専門的な作業環境で使用してください。(微細構造研究所など)

TenuPol-5 は、試料の自動電解薄化を実行するように設計されています。

本機は、品質管理用途として、透過電子顕微鏡(TEM)で微細構造検査を行うための試料を作製する目的に用いられます。

装置は、電解エッチングに適した導電性材料の試料作製用に設計されています。

本機を正しく安全に作動させるために、本機およびこのタイプの装置専用設計された Struers アクセサリおよび消耗品を使用する必要があります。

本機の使用時、触れたり、移動したり、調整したりしないでください。

オペレータは、本装置での電解液の取り扱い方法と使用方法を完全に習得する必要があります。

本装置は、必ず訓練を受けた熟練の担当者が操作してください。

意図したとおりに機能するには、本機を冷却装置に接続する必要があります。

研磨ユニットは必ず平坦な場所に置いてください。

研磨ユニットは、風通しの良い場所(ドラフトチャンバー推奨)に設置してください。

制御ユニット

このユニットの取扱説明書を参照してください。

以下の場合には本装置を使用しないでください

材料組織研究に適している材料以外の材料で試料作製します。

本装置は、あらゆる種類の爆発性/可燃性の材料、機械加工、加熱、加圧時に安定しない材料に使用してはいけません。

本機は十分な換気がない状態で使用しないでください。

本機には、本機と互換性のない消耗品、電解液、アクセサリを組み合わせ使用しないでください。

モデル

TenuPol-5

2.2 TenuPol-5安全に関する注意事項



2.2.1 ご使用の前に必ずお読みください

1. 本情報に従わず、装置を適切に操作しない場合、深刻な怪我を負う、あるいは装置を損傷する可能性があります。
2. 本装置は、現地の安全基準を遵守して設置してください。機械のすべての機能および接続されている装置は、正常に機能している必要があります。本機は接地(アース)されなければなりません。
3. オペレータは、安全上の注意事項と取扱説明書、および接続された装置および付属品の説明書の関連セクションを読む必要があります。
4. オペレータは、本装置での電解液の取り扱い方法と使用方法を完全に習得する必要があります。
5. 電解液の取り扱い、混合、排水、廃棄については、すべての安全要件に従ってください。
6. 本装置は、換気されている場所に設置してください。必要に応じて、ドラフトチャンバに設置することもできます。
7. 本装置は、作業の高さが適切な安全で安定性のある台に設置する必要があります。
8. 本機は、この目的およびこの種の機器用に特別に設計された Struers の消耗品を使用するように設計されています。
9. 本機は、Struers が推奨する電解液を使用するように設計されています。Struers が推奨していない電解液は、使用者の安全を脅かしたり、装置を損傷する可能性があります。

10. 化学火傷の危険。電解液の取り扱い、混合、排水、廃棄については、すべての安全要件に従ってください。
11. 多くの電解液には、アルコールまたはその他の可燃性溶媒が含まれています。これらのタイプの電解液を使用する場合は、常にすべての安全上の注意事項に従ってください。
12. 稼働中は絶対に研磨ユニットを開けないでください。
13. 電解液槽に電解液または水が無い状態でポンプを使用しないでください。
14. Struers社では、装置を離れ無人になるときは、冷却給水栓を遮断するようお願いしています。
15. 常にゴーグル、手袋、その他に推奨される防護服を着用してください。
16. アクセサリ:アクセサリは、この種類の装置用に開発されたものを使用してください。
17. 誤動作を確認した、または異音が聞こえた場合には、装置の電源をオフにして技術サービスに連絡してください。
18. 装置の分解または追加部品の取り付け前には、装置の電源を切り、プラグまたは電源ケーブルを外してください。
19. 実際の電源電圧が、装置に記載されている電圧に対応していることを確認してください。
20. 本装置を点検保守整備する場合は、装置と電源を事前に遮断してください。コンデンサの残留電位がなくなるまで5分間待ちます。
21. Struersの装置は、必ず装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。
22. 装置で誤使用、不適切な設置、改造、不注意、事故、不適切な修理を行った場合、Struersはユーザーまたは装置の損害に対して責任を負いません。
23. サービスまたは修理時の装置部品の分解は、必ず(電気機械、電子、機械、空気圧などに関する)有資格の技術者が実施してください。

2.3 安全メッセージ

Struersでは、潜在的な危険を示す標識を使用しています。



電氣的危険

これは、電氣的な危険が存在することを示します。回避しないと、死亡または重傷を負うことにつながります。



危険

これは、高いレベルの危険が存在することを示します。回避しないと、死亡または重傷を負うことにつながります。



警告

これは、中程度レベルの危険が存在することを示します。回避しないと、死亡または重傷を負うことにつながります。



注意

これは、低いレベルの危険が存在することを示します。回避しないと、軽傷または中程度の怪我を負うことにつながる可能性があります。



挟まれ注意

これは、挟まれる危険が存在することを示します。回避しないと、軽傷、中程度の怪我、重傷を負う可能性があります。



高温危険

これは、挟まれる危険が存在することを示しています。回避しないと、軽度あるいは中程度または深刻な怪我を負う可能性があります。



非常停止
非常停止

一般的な情報



注記

これは、物的損害の危険性、あるいは慎重な取り扱いの必要性を示します。



ヒント

これは、追加情報およびヒントがあることを示しています。

2.4 本説明書の安全メッセージ



警告

Struersの装置は、必ず装置に付属の取扱説明書に従って使用してください。



警告

電解液の取り扱い、混合、排水、廃棄については、すべての安全要件に従ってください。



警告

化学火傷の危険。
電解液の取り扱い、混合、排水、廃棄については、すべての安全要件に従ってください。



注意

作業を開始する前に、各電解液の安全データシートを必ず要求し、読んでください。



注意

多くの電解液には、アルコールまたはその他の可燃性溶媒が含まれています。これらのタイプの電解液を使用する場合は、常にすべての安全上の注意事項に従ってください。

**注意**

オペレータは、本装置での電解液の取り扱い方法と使用方法を完全に習得する必要があります。

**注意**

本機は、Struers が推奨する電解液を使用するように設計されています。Struers が推奨していない電解液は、使用者の安全を脅かしたり、装置を損傷する可能性があります。

**注意****火災と爆発の危険**

- 60%の過塩素酸は非常に腐食性があり酸化しやすい物質です。加熱すると爆発の原因となり、可燃物と接触すると火災が発生する可能性があります。
- 保護された場所で消火を行う必要があります。安全データシートで指定された消火剤を使用してください。

**注意**

電解液の混合、使用、保管、輸送、廃棄に関わるすべての担当者は、これらの作業を行う際の過塩素酸の取り扱い方法についてトレーニングを受ける必要があります。

- 溶液またはその成分から発生する蒸気を吸い込まないでください。
- 肌に付かないよう注意してください。

**警告**

過塩素酸で作業する際は、必ずフルフェイスのシールドまたはスプラッシュゴーグル、ゴム手袋、実験用白衣またはカバーオールを着用してください。

**警告**

必ず、過塩素酸用に設計された化学薬品用ドラフトチャンバで溶媒を混合してください。

**警告**

過塩素酸を取り扱う際は、可燃性または炭素性の容器、反応容器、スピルパン、貯蔵棚、または類似の物質を使用しないでください。

**注意**

たとえば、高沸点酸または脱水剤(硫酸、五酸化リンなど)と一緒に加熱するなど、無水過塩素酸が塩または水溶液から生成されないようにしてください。自発的な爆発に加えて、無水酸が酸化可能な有機材料と接触すると瞬時に爆発します。

**注意**

過塩素酸の使用または保管は、1ドラフトチャンバあたり500g未満の量に制限されています。



注意

研磨ユニットを逆さまにしないでください。特にポンプ内に電解液が入っている場合は、絶対にしないでください。



挟まれ注意

本機を操作中に指を挟まないよう注意してください。



電氣的危険

本機は接地(アース)されなければなりません。
電気装置を設置する際は、必ず電源を切ってから行ってください。
実際の電源電圧が、装置に記載されている電圧に対応していることを確認してください。
電圧が間違っていると、電気回路を損傷する可能性があります。



電氣的危険

残留電気遮断器を装備した電気設備の場合

この機械には残留電流遮断器タイプB、30 mA (以上)を推奨が必要です (EN 50178/5.2.11.1)。

残留電気遮断器を装備していない電気設備の場合

本装置は絶縁変圧器 (二重巻線変圧器) による保護が必要です。

ソリューションを確認するには、認定電気技師に問い合わせてください。

常に現地の規制に従ってください。



注意

大きな音に長時間さらされると、個人の聴力に永久的なダメージを与える可能性があります。
地域の規制を上回る騒音に暴露される場合、耳栓を使用してください。



注意

互換性のないアクセサリや消耗品を使用しないでください。



注意

常にゴーグルまたは保護シールド、および耐薬品性手袋を着用してください。



警告

使用中は装置に触れたり、移動したり、改造したりしないでください。



警告

安全装置に欠陥がある装置を使用しないでください。
Struersサービス部門に連絡してください。



警告
安全上重要なコンポーネントは、最大20年の耐用年数の経過後に交換する必要があります。
Struersサービス部門に連絡してください。



挟まれ注意
本機を操作中に指を挟まないよう注意してください。
重機を取り扱う際は、必ず安全靴を着用してください。

2.5 電解液の使用



警告
化学火傷の危険。
電解液の取り扱い、混合、排水、廃棄については、すべての安全要件に従ってください。



注意
作業を開始する前に、各電解液の安全データシートを必ず要求し、読んでください。



注意
多くの電解液には、アルコールまたはその他の可燃性溶媒が含まれています。これらのタイプの電解液を使用する場合は、常にすべての安全上の注意事項に従ってください。



注意
オペレータは、本装置での電解液の取り扱い方法と使用方法を完全に習得する必要があります。



注意
本機は、Struersが推奨する電解液を使用するように設計されています。Struersが推奨していない電解液は、使用者の安全を脅かしたり、装置を損傷する可能性があります。



注意
多くの電解液には、アルコールまたはその他の可燃性溶媒が含まれています。これらの電解液に対するすべての安全予防措置に従ってください。

稼働率

Struersの電解液は米国では販売されていません。必要に応じて、電解液に必要な化学物質は、個別に購入してください。

詳細については、Struersの代理店にお問い合わせください。

使用後

本機内または研磨した材料上で、電解液を乾燥させたり、結晶化させたりしないでください。

廃棄

次を参照してください: [廃棄 ▶35](#)。

2.5.1 過塩素酸



注意

作業を開始する前に、各電解液の安全データシートを必ず要求し、読んでください。

該当部品の安全データシートを確認するには、こちらを参照してください: www.struers.com



注意

火災と爆発の危険

- 60%の過塩素酸は非常に腐食性があり酸化しやすい物質です。加熱すると爆発の原因となり、可燃物と接触すると火災が発生する可能性があります。
- 保護された場所で消火を行う必要があります。安全データシートで指定された消火剤を使用してください。

トレーニング



注意

電解液の混合、使用、保管、輸送、廃棄に関わるすべての担当者は、これらの作業を行う際の過塩素酸の取り扱い方法についてトレーニングを受ける必要があります。

- 溶液またはその成分から発生する蒸気を吸い込まないでください。
- 肌に付かないよう注意してください。

過塩素酸を電解質溶液と混ぜる

頭文字Aの付いた Struers 電解液を扱う場合、電解質溶液に一定量の過塩素酸を混ぜる必要があります。



警告

過塩素酸で作業する際は、必ずフルフェイスのシールドまたはスプラッシュゴーグル、ゴム手袋、実験用白衣またはカバーオールを着用してください。



警告

必ず、過塩素酸用に設計された化学薬品用ドラフトチャンバで溶媒を混合してください。



警告

過塩素酸を取り扱う際は、可燃性または炭素性の容器、反応容器、スピルパン、貯蔵棚、または類似の物質を使用しないでください。



警告

電解液の詳細については、該当製品の安全データシートを参照してください。

手順

**注意**

コンポーネントは、以下に示す適量で使用してください。

電解液 A2		
1. エタノール、プトキシエタノール、水を混合します。 2. 使用直前に、A2 II - 過塩素酸を A2 I 混合物に追加します。		
配合	A2 I	A2 II
	蒸留水 90 ml エタノール 730 ml プトキシエタノール 100 ml	過塩素酸 78 ml
化学物質	全ての化学物質は化学的純物質であり、望ましくは分析グレードの物質。パーセントは、他に記述がない限り、重量における割合です。	
	プトキシエタノール	エチレングリコールモノブチルエーテル、 CH ₃ -(CH ₂) ₂ -CH ₂ -O-CH ₂ -CH ₂ OH
	エタノール 96% vol	CH ₃ -CH ₂ OH
	過塩素酸	60%、HClO ₄
	蒸留水	H ₂ O
健康と安全		
混合前に、該当コンポーネントのMSDSを熟読してください。 ユーザーは、装置に同梱されている取扱説明書に記載の作業手順の指示に従わなければなりません。		
<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div> <p>注記 製品は、現地の危険物に関する法令に従って廃棄されなければなりません。</p> </div> </div> </div>		

電解液 A3		
1. エタノールとプトキシエタノールを混合します。 2. 使用直前に、A3 II - 過塩素酸を A3 I 混合物に追加します。		
配合	A3 I	A3 II
	エタノール 600 ml	過塩素酸 60 ml
	プトキシエタノール 360 ml	

電解液 A3		
化学物質	全ての化学物質は化学的純物質であり、望ましくは分析グレードの物質。パーセントは、他に記述がない限り、重量における割合です。	
	ブトキシエタノール	エチレングリコールモノブチルエーテル、 CH ₃ -(CH ₂) ₂ -CH ₂ -O-CH ₂ -CH ₂ OH
	メタノール	100% vol.、CH ₃ OH
	過塩素酸	60%、HClO ₄
健康と安全 混合前に、該当コンポーネントのMSDSを熟読してください。 ユーザーは、装置に同梱されている取扱説明書に記載の作業手順の指示に従わなければなりません。		
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>注記 製品は、現地の危険物に関する法令に従って廃棄されなければなりません。</p> </div> </div>		

電解液 D2		
1. リン酸を蒸留水に混ぜます。 2. エタノール、プロパノール、および尿素を追加します。		
配合	D2	
	蒸留水 500 ml	
	リン酸 250 ml	
	エタノール 250 ml	
	プロパノール 50 ml	
	尿素 5 g	
化学物質	全ての化学物質は化学的純物質であり、望ましくは分析グレードの物質。パーセントは、他に記述がない限り、重量における割合です。	
	エタノール	96% vol.、CH ₃ -CH ₂ OH
	リン酸	オルトリン酸85%、(HO) ₃ PO
	プロパノール	2-プロパノール 100%、CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ OH
	尿素	CO(NH ₂) ₂
	蒸留水	H ₂ O

電解液 D2**健康と安全**

混合前に、該当コンポーネントのMSDSを熟読してください。

ユーザーは、装置に同梱されている取扱説明書に記載の作業手順の指示に従わなければなりません。

**注記**

製品は、現地の危険物に関する法令に従って廃棄されなければなりません。

過塩素酸または溶液の保管**注意**

たとえば、高沸点酸または脱水剤(硫酸、五酸化リンなど)と一緒に加熱するなど、無水過塩素酸が塩または水溶液から生成されないようにしてください。自発的な爆発に加えて、無水酸が酸化可能な有機材料と接触すると瞬時に爆発します。

**注意**

過塩素酸の使用または保管は、1ドラフトチャンバあたり500 g未満の量に制限されています。

3. 過塩素酸をボトルの首、キャップ、または他の場所で結晶化させないでください。
4. 化学薬品は、金属、ガラス、またはセラミックのスピルキャッチパンを使用して安全で涼しく換気の良い場所に保管してください。
5. 別の化学物質や可燃性または有機物質から離して保管してください。
6. 溶液は絶対に乾燥させないでください。

詳細については、製品の安全データシートを参照してください。

3 はじめに

3.1 装置の説明

本機は、品質管理の目的で材料を検査するための微細構造検査用試料作製に使用されます。透過電子顕微鏡 (TEM) に適した短時間での試料作製用に設計されています。

電解薄化は、ほとんどの金属材料表面で実施できます。電解液と電気的作用により、導電性材料に電気化学的加工が可能です。処理中、電解液で覆われた試料の領域に高電流が印加されると、表面でエッチング効果が発生します。この処理により、表面は微細構造分析に適したものになります。

装置は、制御ユニットと研磨ユニットで構成されています。

危険な蒸気の吸引を防ぐため、研磨ユニットは換気の良い場所(ドラフトチャンバーを推奨)に設置してください。

オペレータは、研磨ユニット内の電解液の容器を充填したり、空にします。

プロセスを開始する前に、オペレータは試料/サンプル/ワークピースを試料ホルダー/サンプルホルダーに置きます。オペレータは適切なメソッド、アクセサリ、電解液を選択します。事前薄片作成と最終薄片作成には、200種類の研磨/薄片作成メソッドが用意されています。

オペレータは、材料に対して適切な電解液と研磨パラメータの組み合わせが選択されていることを確認します。オペレータは正しい電解液が研磨ユニットに入っていることを確認します。

オペレータがプロセスを開始します。スキャン機能は、薄片作成工程に適した研磨電圧を自動的に決定します。電解エッチング/薄片作成プロセスでは、試料の両側から材料層が除去されます。処理中、電流と電解液の温度が画面に表示されます。

電圧と電流は自動的に監視および調整されます。過剰な熱または電力消費が発生した場合は、ユニットは自動停止します。

試料に穴が開くと、研磨/薄片作成工程は自動的に停止します。

使用後は、電解液容器を空にして水でクリーニングする必要があります。電解液は、安全な場所にある密閉容器に保管してください。クリーニングは水を入れた電解液容器を使用して行います。




注記
本装置の稼働時間と動作寿命を最大限に維持するには、適切なメンテナンスが必要です。




注記
本機は、この目的およびこの種の機器用に特別に設計されたStruersの消耗品を使用するように設計されています。

3.2 概要 - TenuPol-5

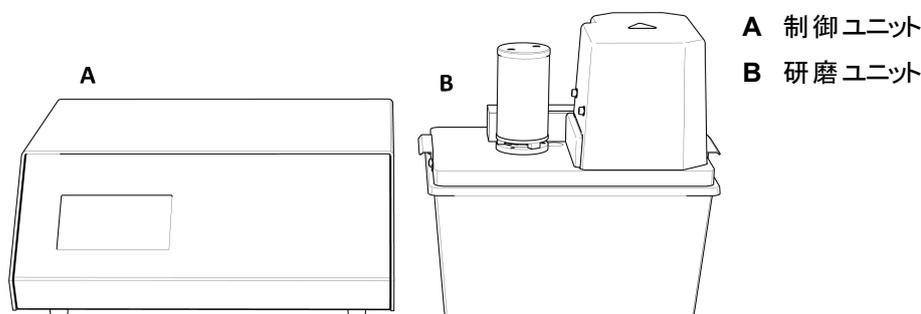

研磨ユニット

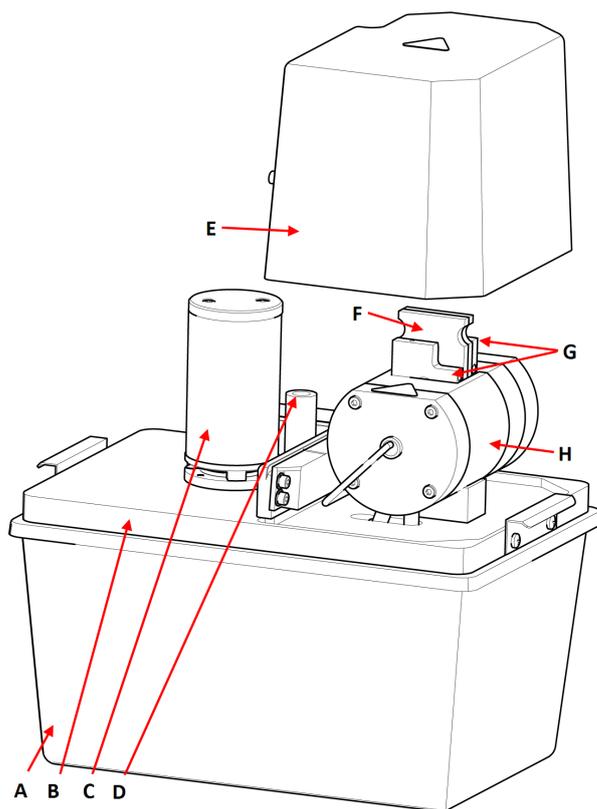

前面 - 研磨ユニット

- A 電解液容器、耐熱
- B ベースプレート
- C ポンプ
- D 温度センサ用開口部
- E 保護カバー
- F 試料ホルダー
- G ジェットホルダー
- H 研磨セル

制御ユニット

当該装置に付属の説明書を参照してください。

3.2.1 制御パネルの機能

TenuPol-5 研磨ユニットに制御パネルがありません。

ユニットは TenuPol-5 制御ユニットから制御されています。当該装置に付属の説明書を参照してください。

4 輸送と保管

インストール後、ユニットを移動またはストレージに保管する必要がある場合は、以下のガイドラインを遵守ください。

- 輸送前にユニットをしっかりと梱包してください。梱包が十分でないと、ユニットを損傷する可能性があります。その場合、保証は無効になります。Struersサービス部門に連絡してください。
- 弊社では、元の梱包材を使用することを推奨しています。



注記

ストラップは、少なくとも本機の2倍の重さに耐えられることが実証されている必要があります。



注記

装置は常に上向きの(立てた)状態で輸送します。



注記

適切な梱包材を使用せずに装置を出荷または輸送しないでください。

輸送

1. TenuPol-5:「開梱の仕方」ドキュメントの項目1～14を読み、しっかりと理解してください。
2. 装置の電源を抜きます。
3. 発泡剤ブロックを圧子とアンビルの間に置きます。
4. リフティングバーの周辺に持ち上げストラップを固定します(項目9および10を参照)。
5. 装置を持ち上げて(その状態で)脚を取り外します。
6. 装置を新しい位置に移動します。

長期保管および輸送

7. 装置をパレットの上に置きます。このとき、パレットの穴と装置の穴を合わせます。
8. 輸送用ボルトを取り付けます。
9. アクチュエータをプラスチック製ストラップで固定します(項目13を参照)。
10. 木箱の各側面を組み立てます。
11. アクセサリケースとその他の取り外し部品を箱に戻します。
12. 装置の乾燥を保つため、乾燥材(シリカゲル)を箱内に入れます。
13. 木箱の蓋を取り付けます。

4.1 輸送

1. 研磨ユニットをしっかりと清掃します。次を参照してください: [クリーニング ▶ 31](#)。
2. 電源供給を遮断します。
3. 研磨ユニットを給水または冷却装置(オプション)から外します。
4. ユニットの新しい位置に移動します。

4.2 保管



注記

弊社では、後で使用するために元の全梱包材を保管することを推奨しています。

- ユニットの電源から外します
- 給水から装置を外します。
- アクセサリを取り外します。
- 保管の前には、ユニットを洗浄し、乾燥してください。次を参照してください: [毎日 ▶30](#)。
- 本装置とアクセサリを元の梱包に戻します。
- 乾燥剤(シリカゲル)の袋を箱に入れます。
- 保管温度と湿度の詳細については、次を参照してください: [技術データ - TenuPol-5 ▶36](#)。

制御ユニット

このユニットの取扱説明書を参照してください。

5 設置

5.1 装置の開梱



注記

弊社では、後で使用するために元の全梱包材を保管することを推奨しています。

装置は2つの箱に梱包されて納品されます。

- 制御ユニット
- 研磨ユニット

研磨ユニット

1. 箱上部の梱包用テープを切ります。
2. 取り外し部品を外します。
3. ボックスからユニットを取り出します。

制御ユニット

このユニットの取扱説明書を参照してください。

装置の移動

次を参照してください: [輸送 ▶18](#)。

5.2 パッキングリストの確認

装置は2つの箱に梱包されて納品されます。

- 制御ユニット

- 研磨ユニット

オプションのアクセサリが梱包箱に含まれる場合があります。

研磨ユニット

箱の中身は以下のとおりです：

個	説明
1	研磨ユニット
1	制御ユニット 接続用電源および通信ケーブル
1	温度計用ポケット
1	試料ホルダー。直径 $\varnothing 3$ mm の試料
1	ジェットホルダー。内径： $\varnothing 1$ mm。2個セット
1	保護カバー
1	電解液容器、耐熱、PVC
1	電解液容器、非耐熱、PVC
2	冷却コイル用チューブ。直径：8 mm。長さ：1 m
1	ジェットホルダー。校正用上昇チューブあり
1	校正用チューブ
1	取扱説明書一式

制御ユニット

このユニットの取扱説明書を参照してください。

5.3 設置場所



挟まれ注意

本機を操作中に指を挟まないよう注意してください。
重機を取り扱う際は、必ず安全靴を着用してください。



警告

研磨ユニットは、風通しの良い場所(ドラフトチャンバー推奨)に設置してください。
使用中は装置に触れたり、移動したり、改造したりしないでください。

- 研磨ユニットは、風通しの良い場所(ドラフトチャンバー推奨)に設置してください。
- ユニットは、表面が平らで安定性があり、適切な高さに固定された作業台に設置します。作業台は化学薬品に耐性がなければなりません。
- ユニットは給水または個別の冷却装置の近くに設置します。
- 2つのユニットに接続する電源および通信ケーブルの長さは2 m (6.5 ft)であるため、別々の場所に配置することができます。

制御ユニット

このユニットの取扱説明書を参照してください。

5.4 電源供給



注意

本機は接地(アース)されなければなりません。
電気装置を設置する際は、必ず電源を切ってから行ってください。
実際の電源電圧が、装置に記載されている電圧に対応していることを確認してください。
電圧が間違っていると、電気回路を損傷する可能性があります。

制御ユニット

このユニットの取扱説明書を参照してください。

5.4.1 電圧



注意

本機は接地(アース)されなければなりません。
電気装置を設置する際は、必ず電源を切ってから行ってください。
実際の電源電圧が、装置に記載されている電圧に対応していることを確認してください。
電圧が間違っていると、電気回路を損傷する可能性があります。




注記

電源が100 - 120 Vの国では、装置の設定を変更する必要があります。

- 115 V: 100 ~ 120 V/50/60 Hz
- 230 V: 200 ~ 240 V/50/60 Hz工場出荷時設定

電圧の変更方法

1. 小型のマイナスドライバーを使用して、制御ユニット背面のヒューズコンパートメントのカバーを開けます。
2. ヒューズコンパートメントからヒューズホルダーを取り外します。
3. ヒューズホルダーを必要な位置に回します。
4. ヒューズコンパートメントに押し戻します。
5. ヒューズコンパートメントのカバーを閉じます。すると、「ウィンドウ」に正しい電圧が表示されます。

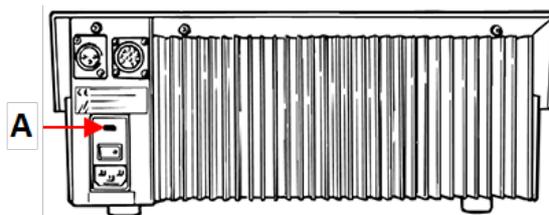

A ヒューズコンパートメント

5.5 研磨ユニットの接続



警告

研磨ユニットは、風通しの良い場所(ドラフトチャンバー推奨)に設置してください。使用中は装置に触れたり、移動したり、改造したりしないでください。

1. 研磨ユニットのケーブルを制御ユニットに付属のアダプタに接続します。
2. アダプタケーブルを制御ユニットの背面に接続します。
3. 保持リングを締めてプラグを固定します。

ポンプをキャリブレーションする

装置のスイッチを初めてオンにするときは、ポンプを調整することをお勧めします。次を参照してください: [ポンプをキャリブレーションする ▶32](#)。

5.6 装置の操作準備



警告

研磨ユニットは、風通しの良い場所(ドラフトチャンバー推奨)に設置してください。使用中は装置に触れたり、移動したり、改造したりしないでください。

5.6.1 研磨ユニットのセットアップ


1. 断熱容器にポンプと冷却コイルとベースプレートを置きます。
2. 温度センサ A を研磨セルとポンプモーターの間の穴に挿入します。



注意

試料作製中は常に温度センサを使用してください。

3. 研磨ユニットに付属のチューブの1本を冷却コイルと冷却水の供給に接続します。

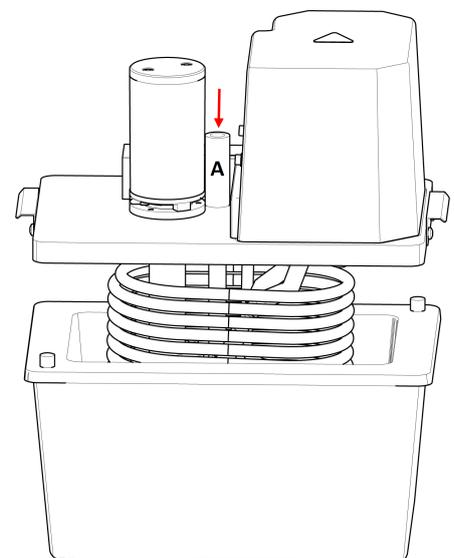

4. 他のチューブを冷却コイルの反対側に接続し、排出口につなぎます。
5. ユニットが外部冷却ユニット(オプション)に接続されている場合は、適切な断熱チューブを使用して冷却ユニットと冷却コイルを接続します。



注記

このユニットの取扱説明書を参照してください。

**ヒント**

電解液を冷却水または外部冷却装置で冷却できない場合は、非耐熱容器を氷浴に入れて冷却します。

5.6.2 容器に電解液を充填する**注意**


電解液の取扱および廃棄については、常に現行の安全規制に従ってください。オペレータは、本装置での電解液の取り扱い方法と使用方法を完全に習得する必要があります。

**警告**

電解液は必ず換気の良い場所で取り扱ってください。
電解液を取り扱うときは、必ず安全手袋、ゴーグル、漏斗を使用してください。


電解液の取り扱い方法については、次を参照してください: [電解液の使用 ▶11](#)。

1. 電解液槽からポンプと冷却コイル付きのベースプレートを取り外します。
2. 電解液槽に電解液 (約 1 l) を充填します。
3. ベースプレートを電解液槽に設置します。

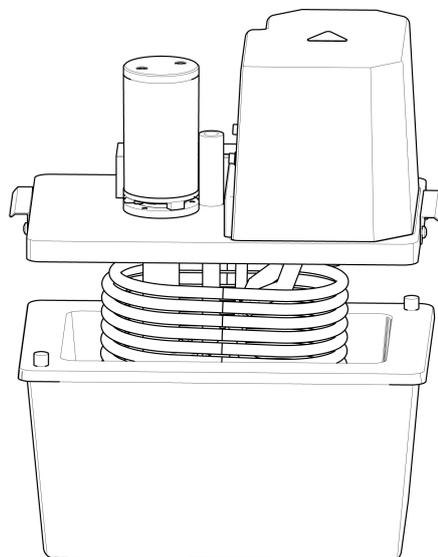


5.6.3 ジェットホルダの取り付け


1. 1つのジェットホルダを研磨チャンバーに設置し、スリーブをチャンバーの後部壁の溝にスライドさせてしっかりと取り付けます。
2. もう一方のジェットも同様にチャンバーの反対側に取り付けます。

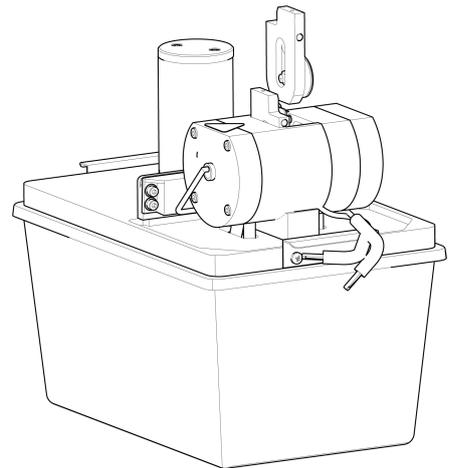

3. 2つのミニジャックプラグをジェットホルダーの対応するソケットに接続します。

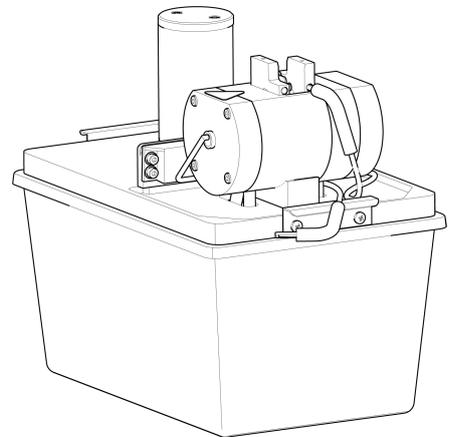

4. 研磨チャンバーに保護カバーをかぶせます。

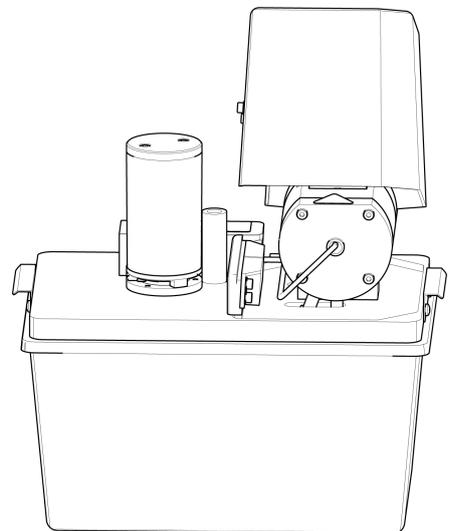

6 メンテナンスと保守

本装置の稼働時間と動作寿命を最大限に維持するには、適切なメンテナンスが必要です。メンテナンスは装置の安全な動作を継続する上で重要です。

このセクションに記載されているメンテナンス手順は、必ず訓練を受けた熟練の担当者が行ってください。

制御システムの安全関連部品 (SRP/CS)


特定の安全関連部品については、この説明書の「技術データ」のセクション「制御システムの安全関連部品 (SRP/CS)」を参照してください。

技術的な質問とスペアパーツ


技術的な質問またはスペアパーツのご注文の際は、シリアル番号と電圧/周波数をご提示ください。シリアル番号および電圧は、装置の銘板に記載されています。

6.1 手動機能

ソフトウェアにはさまざまなマニュアル機能があります。

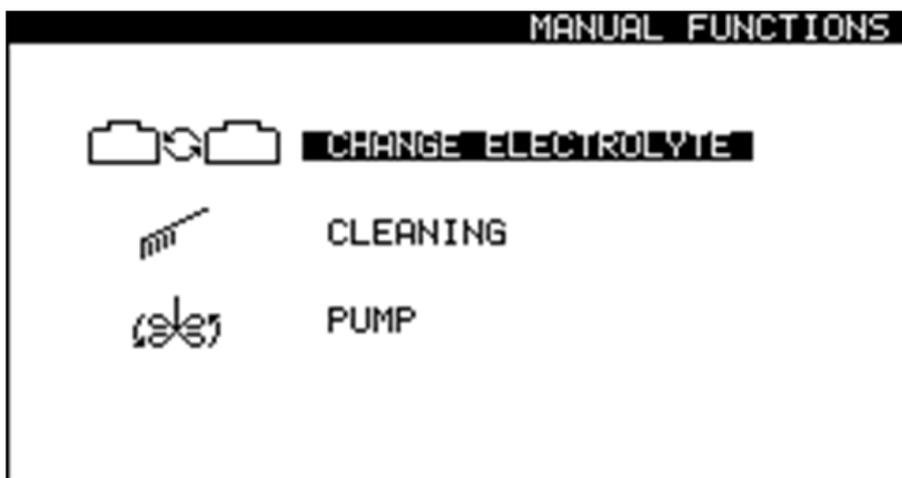

1. **Main menu** (メインメニュー) 画面で **Manual funct.** (手動機能) 画面を選択します。



Manual Functions (手動機能) 画面で、以下のオプションを選択できます。

-  • **Change electrolyte** (電解液の交換). 次を参照してください: [電解液の交換 ▶26](#)。
-  • **Cleaning** (クリーニング). 次を参照してください: [クリーニング ▶31](#)。
-  • **Pump** (ポンプ). 次を参照してください: [ポンプの手動操作 ▶29](#)。

6.1.1 電解液の交換

1種類の電解液を使用するメソッドから、異なるタイプの電解液を使用するメソッドに変更する場合は、電解液を交換する必要があります。電解液を交換してシステムを洗浄するよう指示されます。必要に応じて、この機能を手動で開始できます。



注意

常にゴーグルまたは保護シールド、および耐薬品性手袋を着用してください。



警告

使用中は装置に触れたり、移動したり、改造したりしないでください。

1. **Main menu** (メインメニュー) 画面で **Manual funct.** (手動機能) 画面を選択します。
2. **Manual Functions** (手動機能)画面で**Change electrolyte** (電解液の交換)画面を選択します。
3. **エンター**を押して続行します。
4. 画面の指示に従います。画面に表示される指示は次のとおりです。
5. **エンター**を押して、連続手順を続行します。



処理はいつでもキャンセルできます。これを行うには、**エスケープ**を押します。



6. 以下のメッセージが表示されます。

[Remove Electrolyte:]

1. Lift the polishing unit.
2. Place it in the container with water
3. Remove the present elec.

([電解液を取り出す:]

1. 研磨ユニットを持ち上げます。
2. 水を入れた容器に入れます。
3. 現在の電解液を取り外します。)

[Cleaning...]

The system is being cleaned now.

Please wait 54s

クリーニング

システムを清掃しています。

54秒お待ちください)

[Cleaning done]

1. Lift the polishing table.

2. Use alcohol to remove water.

3. Clean off the remaining alcohol.

([洗浄終了]

1. 研磨テーブルを持ち上げます。

2. アルコールを使用して水分を除去します。

3. 残りのアルコールを拭き取る。)

[Remove water]

Remove the water.

([水分の除去]

水分を除去します。

[Select new Electrolyte]

A2

A3

A8

...

10% oxalic

USER 1

([新しい電解液を選択]

A2

A3

A8

...

10%シュウ酸

ユーザー1)

6.1.2 クリーニング

本機の使用が終了したら、必ずシステムを清掃してください。



注意


常にゴーグルまたは保護シールド、および耐薬品性手袋を着用してください。



警告

使用中は装置に触れたり、移動したり、改造したりしないでください。

1. **Main menu** (メインメニュー) 画面で **Manual funct.** (手動機能) 画面を選択します。
2. **Manual Functions** (手動機能) 画面で **Cleaning** (クリーニング) 画面を選択します。
3. **エンター**を押して続行します。
4. 画面の指示に従います。画面に表示される指示は次のとおりです。
5. **エンター**を押して、連続手順を続行します。



処理はいつでもキャンセルできます。これを行うには、**エスケープ**を押します。



6. 以下のメッセージが表示されます。

[**Remove Electrolyte:**]

1. **Lift the polishing unit.**
2. **Place it in the container with water**
3. **Remove the present elec.**

([電解液を取り出す:]

1. 研磨ユニットを持ち上げます。
2. 水を入れた容器に入れます。
3. 現在の電解液を取り外します。)

[Cleaning...]

The system is being cleaned now.

Please wait 54s

クリーニング

システムを清掃しています。

54秒お待ちください)

[Cleaning done]

1. Lift the polishing table.

2. Use alcohol to remove water.

3. Clean off the remaining alcohol.

([洗浄終了]

1. 研磨テーブルを持ち上げます。

2. アルコールを使用して水分を除去します。

3. 残りのアルコールを拭き取る。)

[Remove water]

Remove the water.


([水分の除去]

水分を除去します。

6.1.3 ポンプの手動操作

ポンプを作動させて、手動で流量を調整できます。

1. **Main menu** (メインメニュー) 画面で **Manual funct.** (手動機能) 画面を選択します。
2. **Manual Functions** (手動機能)画面で**Pump** (ポンプ)画面を選択します。
3. **エンター**を押します。
4. 流量を調整してください。
5. **エンター**または**エスケープ**を押してポンプを停止します。



6.2 毎日

作業終了後は装置を毎日クリーニングしてください。電解液が研磨セル内に残っているとその後の試料作製に影響を与える可能性があります。

研磨ユニット

新しい電解液を充填する前、および1日の作業が終了したら、研磨セルとポンプを水でよくすすいでください。



警告

アセトンやその他類似の溶剤を絶対に使用しないでください。



注意

研磨ユニットを逆さまにしないでください。特にポンプ内に電解液が入っている場合は、絶対にしないでください。



注記

装置に長時間電解液を注入したままにしないでください。浸漬部品が腐食する可能性があります。



注記

モーターハウジングが電解液に触れないようにしてください。



注記

銅または銅合金を使用している場合、銅の一部が陰極に沈着する可能性があります。すすぐ前に硝酸を数滴落として取り除きます。

1. **Main menu** (メインメニュー) 画面で **Manual funct.** (手動機能) 画面を選択します。
2. **Manual funct.** (手動機能) 画面で、**Pump** (ポンプ) 画面を選択します。次を参照してください: [ポンプの手動操作 ▶29](#)。
3. ポンプを始動させ、流量を50に設定します。
 - ジェットからの流れが等しいこと、詰まりがないことを確認してください。
 - 詰まりや漏れを発見した場合は、ポンプを再始動する前にポンプを停止し、ジェットを十分にクリーニングしてください。
 - ジェットからの流れが十分になるまで繰り返します。
 - ポンプを停止します。
4. 試料ホルダーを研磨チャンバーに配置します。
5. クリーニング手順に従ってください: 次を参照してください: [クリーニング ▶31](#)。



6. クリーニングプログラムが終了したら湿った布で、電解液槽内部を含むすべての表面の汚れを拭き取ります。
7. 使用したすべての試料ホルダーをしっかりとクリーニングします。

6.2.1 クリーニング

本機の使用が終了したら、必ずシステムを清掃してください。



注意


常にゴーグルまたは保護シールド、および耐薬品性手袋を着用してください。



警告

使用中は装置に触れたり、移動したり、改造したりしないでください。

1. **Main menu** (メインメニュー) 画面で **Manual funct.** (手動機能) 画面を選択します。
2. **Manual Functions** (手動機能) 画面で **Cleaning** (クリーニング) 画面を選択します。
3. **エンター** を押して続行します。
4. 画面の指示に従います。画面に表示される指示は次のとおりです。
5. **エンター** を押して、連続手順を続行します。



処理はいつでもキャンセルできます。これを行うには、**エスケープ** を押します。

6. 以下のメッセージが表示されます。

[Remove Electrolyte:]

1. **Lift the polishing unit.**
2. **Place it in the container with water**
3. **Remove the present elec.**

([電解液を取り出す:]

1. 研磨ユニットを持ち上げます。
2. 水を入れた容器に入れます。
3. 現在の電解液を取り外します。)

[Cleaning...]

The system is being cleaned now.

Please wait 54s

クリーニング

システムを清掃しています。

54秒お待ちください)

[Cleaning done]

1. Lift the polishing table.

2. Use alcohol to remove water.

3. Clean off the remaining alcohol.

([洗浄終了]

1. 研磨テーブルを持ち上げます。

2. アルコールを使用して水分を除去します。

3. 残りのアルコールを拭き取る。)

[Remove water]

Remove the water.

([水分の除去]

水分を除去します。

6.2.2 制御ユニット

- キャビネットまたは制御ユニットのフロントプレートに電解液がこぼれないようにしてください。
- 使用後は、湿らせた布でフロントプレートの汚れを拭き取ります。

6.3 毎月

循環ユニット

このユニットの取扱説明書を参照してください。



注記

藻類や細菌による汚染に気付いた場合は、直ちに冷却液を交換してください。

6.3.1 ポンプをキャリブレーションする

本機を初めてオンにする場合

ポンプは初めて使用する前に調整する必要があります。

ポンプの調整手順を開始するには、以下を実行します。

1. 本機の電源を初めて入れると、次のメッセージが表示されます。
The pump must be adjusted. (ポンプの調整が必要です。)
1. キャリブレーションホルダーを研磨セルに挿入します。
2. 温度センサの穴に黒いチューブを入れます。
3. キャリブレーションホルダーを接続します。
4. **Adjust with tube** (チューブで調整) を選択します。
5. ポンプの調整手順を続けるには、このセクションの次を参照してください: [調整の実行 ▶33](#)

その後の使用

結果が正しくない場合、または結果を再現できない場合は、ポンプを調整してください。

この機能は研磨ユニットのポンプを校正し、Struers メソッドの流量設定が正しいことを確認します。

1. キャリブレーションホルダーを研磨セルに挿入します。
2. 温度センサの穴に黒いチューブを入れます。
3. キャリブレーションホルダーを接続します。
4. **Main menu** (メインメニュー) 画面で **Configuration** (環境設定) 画面を選択します。
5. **F4 - Adj. Pump** (調整ポンプ) を押します。
6. ポンプの調整手順を続けるには、このセクションの次を参照してください: [調整の実行 ▶33](#)

調整の実行

以下のメッセージが表示されます。

Insert container

Please insert a container filled with 1.5 litre water.

Add a drop of detergent.

(容器を挿入

1.5リットルの水を入れた容器を挿入してください。

洗剤を一滴入れます。)

7. 1.5リットルの水を容器に入れます。
8. 洗剤を1滴添加して水の表面張力を低減させます。

9. **エンター**を押して続行します。

以下のメッセージが表示されます。

Insert tubes

Insert jet holder with ascending tube, return tube and specimen holder with specimen.

(チューブを挿入

ジェットホルダーに上昇チューブ、リターンチューブ、試料ホルダーを挿入します。)

10. 指示通りに操作してください。

11. **エンター**を押して続行します。



12. **Maximum pump flow** (最大ポンプ流量)を選択します。

13. **エンター**を押して、ポンプを始動します。



14. 上限まで水を入れます。最大設定は約120lにします。



15. **エンター**を押して値を保存します。



16. **Minimum pump flow** (最小ポンプ流量)を選択します。

17. 下限まで水を入れます。最小設定は約75lにします。



18. **エンター**を押して値を保存します。



19. 調整が完了したら、**エスケープ**を押します。



6.4 毎年

安全装置は少なくとも毎年1回テストを行ってください。

6.4.1 安全装置のテスト



警告

安全装置に欠陥がある装置を使用しないでください。Struersサービス部門に連絡してください。

保護カバー

安全装置は少なくとも毎年1回テストを行ってください。



警告
安全装置に欠陥がある装置を使用しないでください。
Struersサービス部門に連絡してください。

手順

1. 保護カバーと作業域インターロックを検査するには、作業域インターロックを含む保護カバーを取り外します。
2. スタートを押します。
3. 研磨が開始しないことを確認します。



6.5 予備部品

技術的な質問とスペアパーツ

技術的な質問またはスペアパーツのご注文の際は、製造年をご提示ください。製造年はシリンダフレームに刻印されています。

詳しい情報、またはスペアパーツの入手可否の確認に関しては、Struersサービス部門にお問い合わせください。連絡先情報は、[Struers.com](https://www.struers.com)に掲載されています。

6.6 廃棄



WEEE記号の付いた装置には、電気および電子部品が使用されているため、一般の廃棄物として廃棄できません。

国内規制に準拠した正しい廃棄方法に関する詳細については、地方自治体にお問い合わせください。

消耗品および循環液の処分については、現地の規制に従ってください。

電解液

国内規制に準拠した正しい廃棄方法に関する詳細については、地方自治体にお問い合わせください。

6.7 サービスおよび修理

弊社では、年に1回、または運転1,500時間ごとに、定期点検と整備の実施を推奨しています。

装置を起動すると、合計操作時間と装置の保守情報が表示されます。

操作時間が1500時間を経過すると、保守点検を実施する必要があることをユーザーに通知するメッセージが表示されます。



注記
サービスは、必ず(電気機械、電子、機械、空気圧などに関する)資格を持つ技術者が実施してください。
Struersサービス部門に連絡してください。

7 トラブルシューティング

制御ユニット

エラー	原因	動作
電源電圧が低過ぎます。	電源電圧が制御ユニットの背面に記載されている値より低くなっています。	必要に応じて、電圧設定を変更します。次を参照してください： 電圧 ▶21 。
電気接続がありません。	研磨ユニットに接続されていません。	琢磨ユニットが制御ユニットの背面に接続されていることを確認します。
	電解液槽の電解液が不足しています。	容器内の電解液の量を最大1.5lまで増やします。
	保護カバースイッチが作動していません。	保護カバーが溝に正しく配置されていることを確認すると、制御ユニットでリレーのカチツという音がします。
温度が上限を超えています。	電解液の温度が事前に設定された限度を超えています。	デバイスを水道水または外部冷却装置に接続して、温度が指定された制限値を下回るまで待ちます。
デバイスはオンになっていますが、ディスプレイが空白です。	ディスプレイのバックライトがオフになっています。	任意のボタンを押すと、バックライトが点灯します。

関連項目 TenuPol-5 制御ユニット、結果の最適化。

8 技術データ

8.1 技術データ - TenuPol-5

項目	仕様	
ソフトウェアと電子機器	TenuPol-5 制御ユニット 提供。このユニットの取扱説明書を参照してください。	
電源供給	TenuPol-5 制御ユニット 提供。このユニットの取扱説明書を参照してください。	
出力: 電圧/現在	琢磨	0 ~ 100 V (0.1 V単位)/2.5 A
安全規格	「適合宣言」を参照	

項目	仕様	
寸法と質量	幅	270 mm (10.6")
	奥行き	180 mm (7.1")
	高さ	276 mm (10.9")
	重量	3.8 kg (8.4 lbs)
動作環境	環境温度	5 ~ 40°C (41 ~ 104°F)
	湿度	0-95 % RH (結露なきこと)
保管/輸送時条件	環境温度	-25-55°C (13-113°F)
	湿度	0-95 % RH (結露なきこと)

8.2 騒音レベルと振動レベル

ノイズレベル	仕事場におけるA特性放射音圧レベル	L _{pA} = 55.4 dB(A) 測定値 不確定値 K = 4 dB EN ISO 11202 に準拠して測定実施
振動レベル	N/A (該当なし)	

8.3 安全回路カテゴリパフォーマンスレベル

安全回路カテゴリパフォーマンスレベル	
ワークゾーンインターロック	EN 60204-1、ストップカテゴリ0 EN ISO 13849-1、カテゴリ1 PL c

8.4 制御システムの安全関連部品 (SRP/CS)



警告

安全上重要なコンポーネントは、最大20年の耐用年数の経過後に交換する必要があります。

Struersサービス部門に連絡してください。



注記

SRP/CS (制御システムの安全関連部品) は、装置の安全な操作に影響を与える部品です。



注記

安全上重要な部品の交換は、ストルアスのエンジニアまたは有資格の技術者(電気機械、電子、機械、空気圧など)のみが行います。

安全上重要なコンポーネントは、少なくとも同じ安全レベルを持つコンポーネントとのStruersサービス部門に連絡してください。

安全関連部品	メーカー / メーカーの説明	メーカーのカタログ番号	電気基準	ストルアスのカタログ番号
インターロックスイッチ回路 - 研磨ユニット	Schmersal コード付きマグネット センサ	BNS33-11Z-2M	SS1	2SS00140
インターロックスイッチ回路 - 研磨ユニット	Schmersal センサ用コード付きマグネット (アクチュエータ)	BPS33	SS1	2SS00141
インターロックスイッチ回路 - 研磨ユニット	Finder パワーリレー	62.32.9.024.4800	K1	2KL46680

8.5



注記
特定の情報の詳細を見るには、本説明書のオンライン版をご覧ください。

8.5.1 - TenuPol-5


制御ユニット

このユニットの取扱説明書を参照してください。

研磨ユニット

タイトル	番号
TenuPol-5、ブロック図	15393051 A
TenuPol-5、接続アダプタ	15393508 B

15393508 B

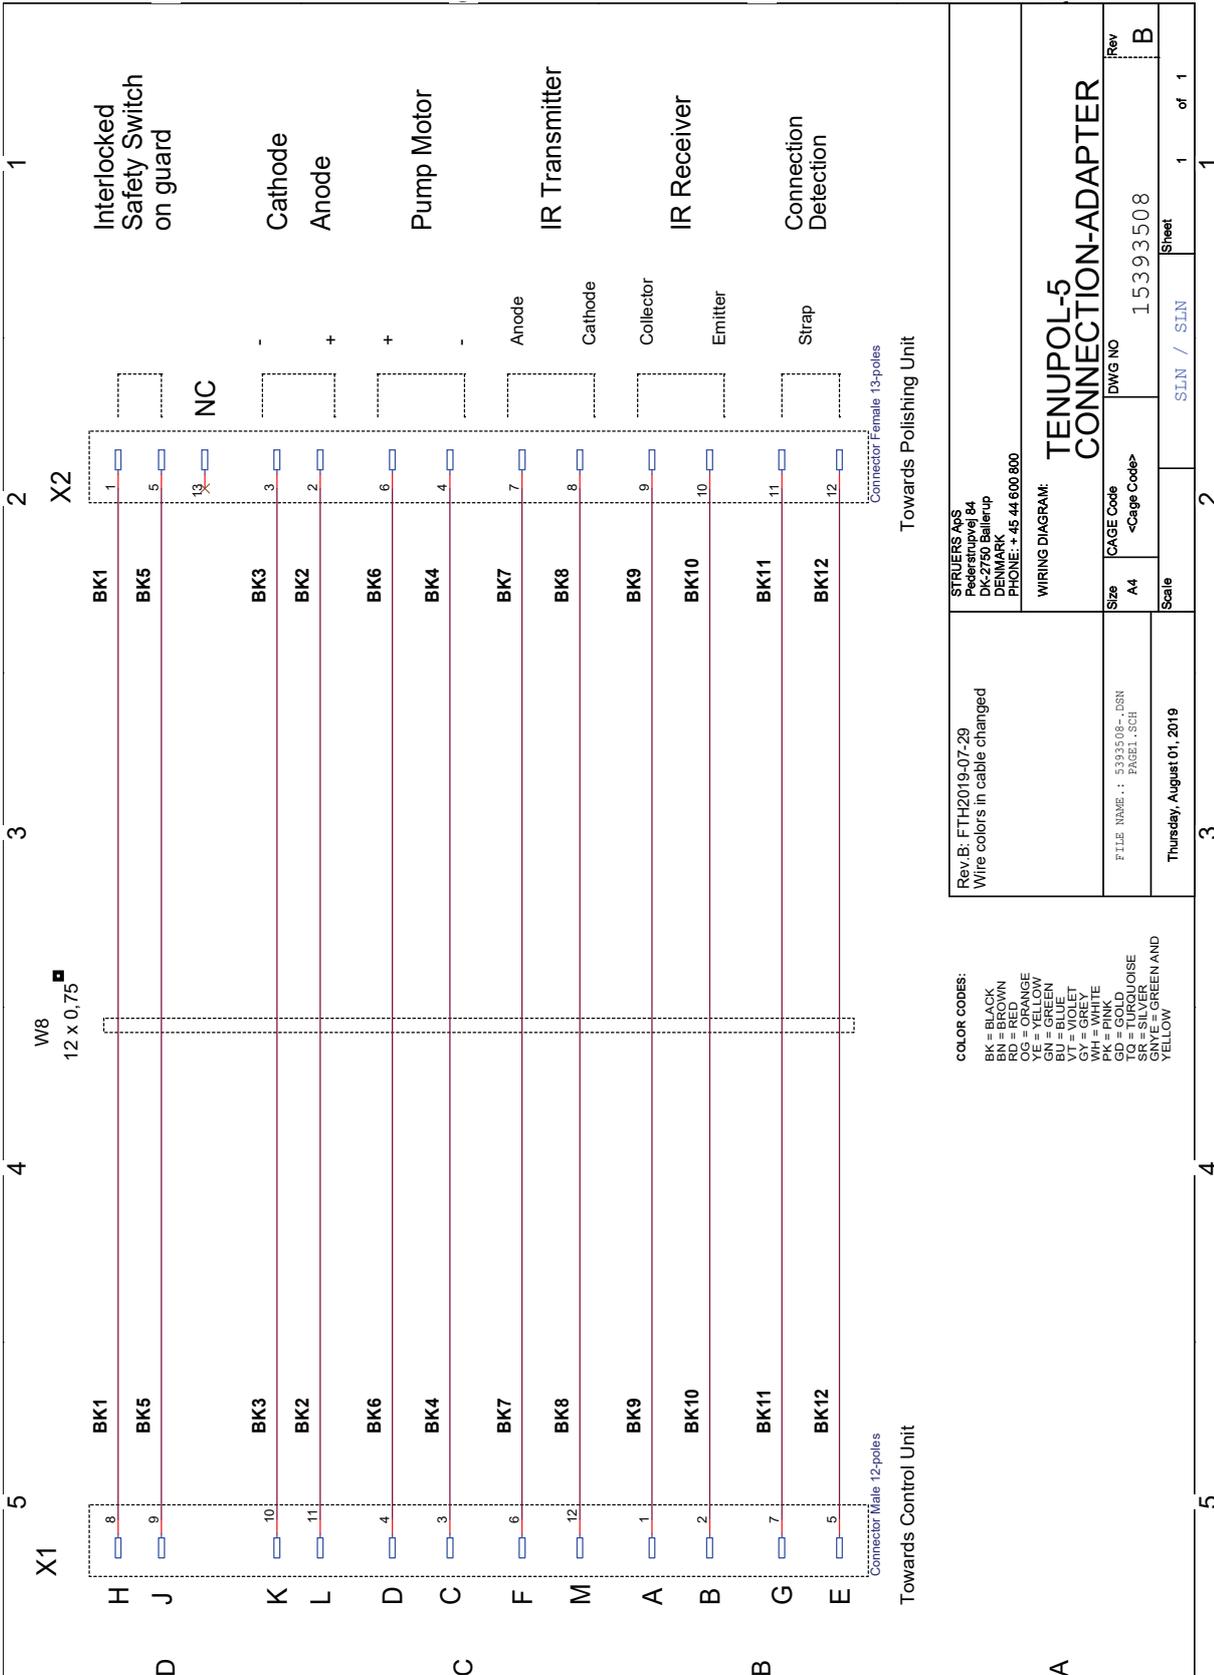

STRUERS Aps Petersbølvej 64 DK-2670 Ballerup DENMARK PHONE: + 45 44 600 800		TENUPOL-5 CONNECTION-ADAPTER	
Rev.B: FTH2019-07-29 Wire colors in cable changed		Size A4	Rev B
FILE NAME: 5393508-.DSN PAGE1.SCH		CAGE Code <Cage Code>	DWG NO 15393508
Thursday, August 01, 2019		Scale	Sheet 1 of 1

- COLOR CODES:
- BK = BLACK
 - RD = RED
 - GR = GREEN
 - OG = ORANGE
 - YE = YELLOW
 - BL = BLUE
 - VI = VIOLET
 - GRY = GREY
 - PK = PINK
 - GD = GOLD
 - BR = BROWN
 - SR = SILVER
 - GNYE = GREEN AND YELLOW

8.6 法的小よび規制情報

FCC通知

本装置は、FCC規則パート15に基づいたクラスB デジタルデバイスの規制に準拠していることが試験、実証されています。これらの制限は、住宅施設における有害な干渉に対して妥当な保護を提供するためです。本装置は、無線周波数エネルギーを生成、使用しており、放射する可能性があります。本装置が説明書に従って設置、使用されない場合、無線通信に対する有害な妨害を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置において干渉が発生しない保証はありません。この装置が無線またはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合は、機器の電源を切ってオンにすることで判断できる場合、ユーザーは以下のいずれか(またはすべて)の対処によって干渉を修正することが推奨されます。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 装置および受信機の間を距離を離す。
- 受信機が接続されている回路とは異なる回路のコンセントに装置を接続します。

9 製造元

Struers ApS
Pederstrupvej 84
DK-2750 Ballerup、デンマーク
電話: +45 44 600 800
ファックス: +45 44 600 801
www.struers.com

メーカーの責任

次の制約事項を遵守してください。制約事項に違反した場合は、Struersは法的義務を免除されることがありますので、ご注意ください。

本取扱説明書のテキストやイラストの誤記については、メーカーは責任を負いません。本取扱説明書の内容を、予告なしに変更する場合があります。本取扱説明書では、供給したバージョンの装置にはない付属品や部品について記載している場合があります。

メーカーは、使用の取扱説明書に従って装置が使用、保守、および維持されている場合にのみ、機器の安全性、信頼性、および性能に対する影響の責任を負うものとします。

適合宣言書

製造元	Struers ApS • Pederstrupvej 84 • DK-2750 Ballerup • デンマーク
名称	TenuPol-5 研磨ユニット
モデル	N/A (該当なし)
機能	TenuPol-5、電解薄化用研磨ユニット
種類	408
カタログ番号	04086002 TenuPol-5 研磨ユニット 併用: 05396233 TenuPol-5制御ユニット
シリアル番号	



モジュールHは、グローバルなアプローチを遵守



当社は、記載された製品が以下の法律、指令、規格に準拠していることを宣言します。

2006/42/EC	EN ISO 12100:2010)、EN ISO 13849-1:2015、EN ISO 13849-2:2012
2011/65/EU	EN IEC 63000:2018
2014/30/EU	EN 61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN 61000-6-1:2007、EN 61000-6-3:2007、 EN 61000-6-3-A1:2011、EN 61000-6-3-A1-AC:2012
追加規格	NFPA 70、NFPA 79、FCC 47 CFR パート 15、サブパートB

技術ファイルの編集権限 /
承認署名者

日付: [Release date]

en For translations see
bg За преводи вижте
cs Překlady viz
da Se oversættelser på
de Übersetzungen finden Sie unter
el Για μεταφράσεις, ανατρέξτε στη διεύθυνση
es Para ver las traducciones consulte
et Tõlked leiate aadressilt
fi Katso käännökset osoitteesta
fr Pour les traductions, voir
hr Za prijevode idite na
hu A fordítások itt érhetőek el
it Per le traduzioni consultare
ja 翻訳については、
lt Vertimai patalpinti
lv Tulkojumus skatīt
nl Voor vertalingen zie
no For oversettelser se
pl Aby znaleźć tłumaczenia, sprawdź
pt Consulte as traduções disponíveis em
ro Pentru traduceri, consultați
se För översättningar besök
sk Preklady sú dostupné na stránke
sl Za prevode si oglejte
tr Çeviriler için bkz
zh 翻译见

www.struers.com/Library